

Link do produktu: <https://redmed.pl/analizator-inr-qlabs-q1-en-dla-osob-z-wszczepiona-zastawka-micropoint-q-1-p-808.html>



analizator INR qLabs Q1 EN dla osób z wszczepioną zastawką Micropoint Q-1

Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MBQ1
Kod producenta	Q-1 EN
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Sprzedawana wersja nie posiada menu w języku polskim. Można wybrać język angielski, francuski, portugalski.

System qLabs® model Q-1 to monitor do kontroli wskaźnika INR i PT z krwi pobranej najczęściej z palca pacjenta. Ten model qLabs Q-1 jest przeznaczony dla osób, które muszą kontrolować wskaźnik INR, zwłaszcza u osób z **migotaniem przedsionków**, u osób **po wymianie zastawki**, lub u osób **po przebytej zatorowości płucnej** u których włączono terapię doustnymi tradycyjnymi lekami tzw. antykoagulantami. W przypadku zastosowań w jednostkach szpitalnych zastosowanie znajdzie inny model [qLabs® Plus model Q-2](#), który ma możliwość dodatkowo drukowania wyników, skanowania kodów pacjenta, oraz możliwość pomiaru INR, PT, aPTT, fibrynogenu, oraz TT, czyli czasu trombinowego.

qLabs® Q-1 to monitor krzepliwości krwi do szybkiego i precyzyjnego określania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi pełnej z palca.

Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. Micropoint qLabs® Q-1 oferuje pacjentom, dostęp do wyników gęstości krwi o jakości laboratoryjnej. Zaawansowana technologia biosensoryczna analizatora umożliwia szybkie wykonanie pomiaru krzepliwości krwi z krwi kapilarnej. System do pomiaru INR jest łatwy i tani w utrzymaniu oraz konserwacji, składa się z przenośnego analizatora do pomiaru INR oraz jednorazowych, indywidualnie pakowanych pasków testowych.

Szybki procesor i duża pamięć. Do produkcji obudowy użyto nowocześniejszego tworzywa, oraz zastosowano antypoślizgową, niebieską, gumową opaskę na obrzeżach urządzenia, dzięki której monitor INR świetnie leży w dłoni. Kolejnym dodanym elementem w nowym qLab jest wbudowany Bluetooth. Funkcja ta będzie wykorzystywana w aplikacjach do przesyłania wyników do lekarza oraz uzyskiwania konsultacji medycznych kardiologicznych z zakresu prawidłowej terapii tradycyjnymi lekami antykoagulacyjnymi. Ma to zastosowanie w przypadku możliwości przesłania wyniku przez telefon lub komputer do lekarza, od którego uzyskamy informacje o dawce leku lub informacje o jej wartości lub jej zmodyfikowaniu.

Do zrobienia badania jest potrzebne jedynie 10 µL krwi z opuszka palca.

Przygotowanie i wykonanie badania zajmuje tylko od 1 do 5 minut, a wynik PT i INR jest wyświetlany po kolejnych 2 minutach.

Wbudowana kontrola jakości (QC) daje pewność jakości wyników, minimalizuje ryzyko nieprawidłowego pomiaru.

Własna pamięć w której może przechowywać aż do 200 ostatnich wyników badań.

Antypoślizgowe elementy obudowy, dzięki którym można pewnie się posługiwać analizatorem trzymając go w jednej dłoni.

Gwarancja na 1 rok w standardzie.

Integralnym elementem systemu Micropoint qLabs® Q-1 są osobno pakowane jednorazowe paski testowe. Zastosowanie takiego rozwiązania służy ochronie urządzenia i badanej próbki przed zanieczyszczeniem. Próbka nie zanieczyści analizatora powodując tym samym nieprawidłowe wyniki testu. Ponieważ nie wymaga czyszczenia po każdym badaniu, można wykonywać seryjne testy INR. Paski testowe można przechowywać w temperaturze pokojowej, przez co są natychmiast gotowe do użycia.

Micropoint qLabs® Q-1 En jest dla pacjentów i personelu medycznego

System został zaprojektowany dla pacjentów stosujących leki rozrzedzające krew w terapii przeciwzakrzepowej. Można na bieżąco, w wygodnych warunkach domowych monitorować krzepnięcie krwi wskaźnika PT i INR. Informacje z regularnych i częstych badań, przekazane lekarzowi prowadzącemu, pomagają w obserwacji postępów terapii, oraz, w razie konieczności, zmodyfikowaniu dawek przyjmowanych leków. Dysponowanie takim analizatorem krzepliwości krwi zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ w razie zauważenia niebezpiecznych zmian w parametrach krzepnięcia można szybko zastosować środki zaradcze, skontaktować się z lekarzem lub przekazać ważną informację diagnostyczną kiedy będzie potrzebna nagła interwencja medyczna.

W przypadku profesjonalnej opieki zdrowotnej, takiej jak przychodnie, gabinety lekarskie, punkty pierwszego kontaktu z pacjentem czy punktów diagnostyki medycznej, Micropoint qLabs® Q-1 oferuje wyniki o jakości i dokładności porównywalnej z laboratoryjną, które można uzyskać w ciągu kilku minut. Lekarz, lub osoba z którą pacjent się konsultuje, może sprawdzić stopień krzepliwości krwi już w trakcie jednej wizyty. Kiedy dysponuje się wynikami PT i INR z ostatniej chwili, konsultacje z pacjentem przyjmującym leki zmieniające stopień krzepliwości krwi, mogą przynieść poprawę jakości terapii.

System do kontroli koagulacji umożliwia dostęp do bieżących wyników gęstości krwi, tak w placówce medycznej, jak i w domu czyniąc go doskonałym narzędziem dla pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Analizator Micropoint qLabs® Q-1 jest lekki i przenośny, a paski testowe, będące istotnym elementem systemu, można przetrzymywać w temperaturze pokojowej. System można bezpiecznie trzymać pod ręką w domu lub wziąć ze sobą w podróż. W przypadku placówek medycznych, analizator można przenosić do różnych gabinetów, pokoi zabiegowych lub nosić ze sobą do różnych placówek.

Testy qLabs

Integralnym elementem systemu qLabs® są indywidualnie pakowane paski testowe. Osobne opakowania chronią paski testowe przed wilgocią oraz zmniejszają ryzyko zakażenia pacjentów. Paski testowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co dodatkowo zmniejsza koszty ich przechowywania. Paski testowe PT/INR są dostępne w opakowaniach po 12, 24 i 48 pasków.

Paski testowe są zawsze dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 12, 24 lub 48 szt. Jeżeli zakupiłeś paski pakowane w opakowaniu foliowym, prawdopodobnie są to paski pochodzące z źródła, którego jakość może budzić podejrzenia.

Najważniejsze cechy systemu Micropoint qLabs® Q-1 En:

- Mała próbka krwi z opuszka palca, minimum 10 µL.
- Wbudowana kontrola jakości testu.
- Czas przeprowadzenia badania 1-5 minut.
- Wynik PT/INR jest wyświetlany w 2 minuty.
- Pamięć 200 wyników testów.
- Łącze Bluetooth
- Przeciypoślizgowa obudowa.
- Możliwość zasilania sieciowego i baterijnego (4 xAA).

Oprogramowanie Data Manager

Do urządzenia dołączane jest oprogramowanie Data Manager, dzięki któremu można przysyłać wyniki do komputera poprzez kabel USB znajdujący się w zestawie. Oprogramowanie oraz sterowniki działają z najnowszymi wersjami systemu Windows.

Program umożliwia:

- zarządzanie wynikami,
- wydruk wyników badań,
- eksport do pliku CSV (możliwy do otworzenia w programie Excel),
- graficzne przedstawienie wyników za pomocą wykresu.

Znak

C € 0123



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs® firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

OGRANICZENIA

- System qLabs® przeznaczony jest do użycia ze świeżą pełną krwią kapilarną. Nie należy używać świeżej krwi żyłnej ani krwi pobranej na antykoagulant
- System qLabs® nie podlega wpływowi heparyny w stężeniach do 1 anti-Xa na mL krwi. Dotyczy to heparyny zarówno niefrakcjonowanej, jak i niskomolekularnej.
- Kropla krwi musi mieć objętość co najmniej 10µl lub musi to być duża wisząca kropla krwi. Mała objętość próbki spowoduje wyświetlenie się komunikatu o błędzie.
- W badaniach in vitro nie wykazano istotnego wpływu w próbkach zawierających bilirubinę w stężeniu do 20mg/dl oraz hemoglobinę w stężeniu 500 mg/dl (hemoliza). Nie stwierdzono istotnego wpływu w przypadku próbek zawierających trójglicerydy w stężeniu do 1500mg/dl (lipemia).
- Paski testowe qLabs® PT-INR działają skutecznie w temperaturze w zakresie 10-35°C oraz w 10-90% RH (wilgotność względna). Dotyczy to oddziaływania powyższych warunków na pasek przez 10 minut po wyjęciu z opakowania.

W opakowaniu z urządzeniem Micropoint qLabs® Q-1 En są:

- Zasilacz z 240V na 7V z wtyczką: Typ B (stosowane w UE, razem z Polską)
- Przewód USB do komunikacji z komputerem
- Instrukcja użytkownika
- Saszetka do bezpiecznego przenoszenia
- 10 Jednorazowych Sterylnych Bezpiecznych Nakłuwaczy 2,4 mm 21G lub 1,8 mm 21G do badania INR
- Poradnik szybkiego startu po Polsku

Każdy zestaw posiada wydrukowaną instrukcję obsługi w języku polskim w formacie A6, instrukcja obsługi została zatwierdzona przez producenta. Jakość tłumaczenia tej instrukcji w znacznym stopniu ułatwia obsługę systemu qLabs.

Inne podobne systemy kontroli krzepliwości krwi INR

[INRatio2](#)

Gwarancja


- Standard 2 lata
- Opcja 3 lata
- Opcja **Premium** - Opcjonalne 4 lat razem z gwarancją wymiany na inny w przypadku braku dostępności pasków testowych lub zaprzestania produkcji w okresie gwarancji.

Szkolenie

- Chorzów

Termin i miejsce szkolenia, do ustalenia po dokonaniu płatności. Ustalony termin musi znajdować się w okresie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia dokonania zapłaty za szkolenie.

GRATIS!

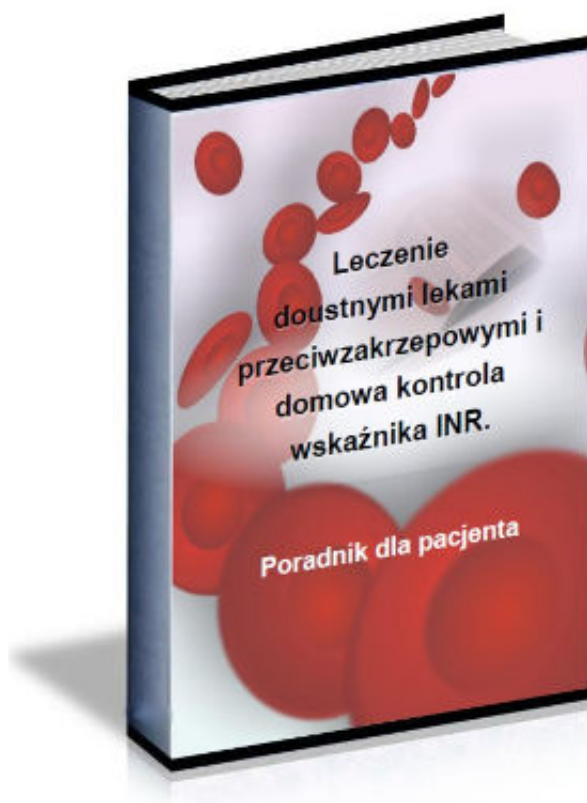

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szkolenie z obsługi qLabs: Brak , Telefonicznie

Gwarancja: standard 2 lata , opcja 3 lata , opcja 4 lata Premium

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com