Dane aktualne na dzień: 04-09-2026 15:55

Link do produktu: https://redmed.pl/refundacja-nfz-i-paski-do-pomiaru-inr-qlabs-24-szt-kontrola-krzepliwosci-krwi-q1-q3-p-806.html

Refundacja NFZ I Paski do pomiaru INR qLabs 24 szt. kontrola krzepliwości krwi Q1 Q3

Cena	**36,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**dzień roboczy do 13:00**
Numer katalogowy	**MPQ3 >> MPQS-1-24**
Kod producenta	**QS-1-24**
Kod EAN / GETIN	**00856003003094**
Producent	**.Micropoint Biotechnologies Co.**
Refundacja NFZ	TAK, W przypadku braku refundacji w pole PIN oraz PESEL wpisać 0
Producent	**Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.**
Podmiot Odpowiedzialny	**Obelis S.A.**
Cena NFZ	**360,00 PLN**

Opis produktu

Jednorazowe paski testowe do systemu qLabs® do pomiaru PT/INR. Szybkie, wygodne i proste określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca. Paski będą pasowały do modeli qLabs Q1 oraz Q3.

Dlaczego paski qLabs® są najdokładniejsze na rynku systemów do kontroli wskaźnika INR PT ?
Paski qLabs® jako jedyne na rynku systemów monitorowania INR PT posiadają wbudowaną w pasek, kontrolę jakości, co oznacza że podczas każdego badania jest wykonywane jednocześnie badanie jakości naniesionej próbki krwi. Dlatego aparat potrzebuje 10ul krwi by ją dostarczyć na dwa kanały, w jednym kanale jest badany wskaźnik INR/PT a w drugim kanale jest badana krew czy jej parametry są odpowiednie by wykonać badanie i wynik przedstawić użytkownikowi.

Czasami użytkownik może nanieść próbkę krwi zanieczyszczoną np. alkoholem, lub kremami do rąk i każdy z systemów w takim wypadku zbada próbkę krwi i będzie obarczony błędem pomiarowym o czym użytkownik innych systemów krzepliwości krwi nie zostanie poinformowany. W odróżnieniu system qLabs, właśnie wykona kontrolę jakości próbki krwi, i jeśli próbka będzie zanieczyszczona wyświetli komunikat, tym samym poinformuje użytkownika odpowiednim komunikatem.

Dlatego też każdy system który jest refundowany powinien zawierać właśnie wbudowany system kontroli jakości, o czym informuje rozporządzenie ministra zdrowia.

Cechy testów do qLabs

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbka: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żylnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s.

Opakowanie pasków QS-1-24 do qLabs zawiera:

- 24 paski testowe PT/INR, pakowane w indywidualne hermetyczne opakowania, gwarantujące najdokładniejsze wyniki,
- Kartę kalibrującą do modelu Q3 oraz KOD Paska do Q1,
- Polską instrukcję obsługi.

Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do Monitorów INR qLabs® pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi jest potrzebna jedynie mała próbka krwi z opuszka palca. Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia. Paski testowe przeznaczone są do samodzielnej kontroli gęstości krwi przez pacjenta.

Zastosowana nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników. Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.

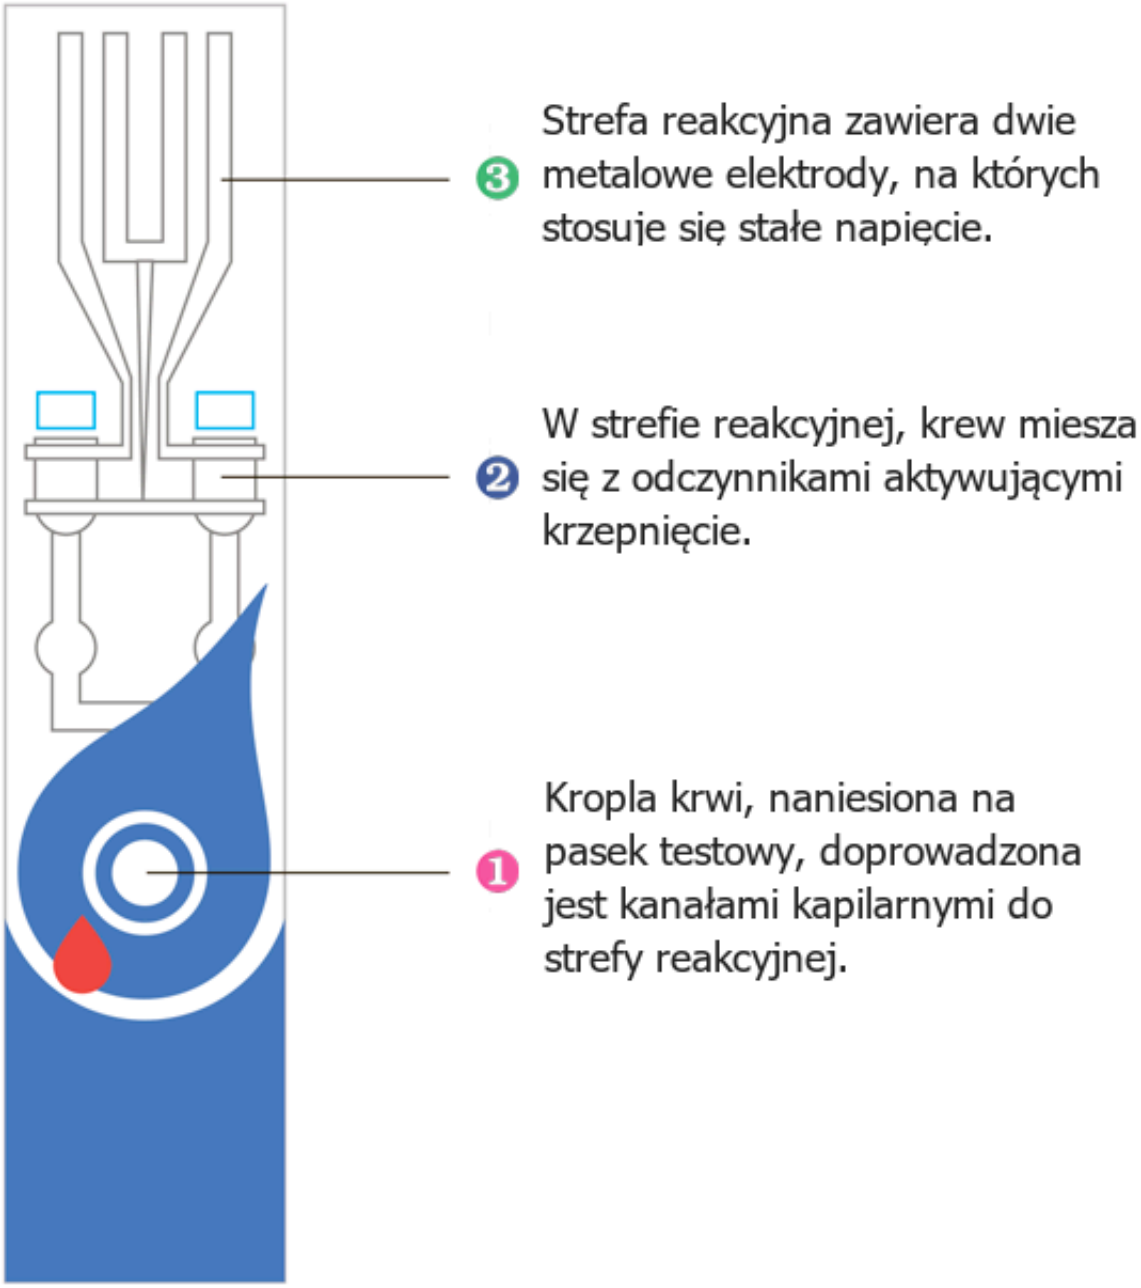

Monitor INR qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. Monitor INR oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Każdy pasek testowy współpracuje z wbudowaną kontrolą jakości wykonywaną podczas każdego badania, a system kontroli jakosci opiera się o elementy:

- Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Znak CE 0123

Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Poradnik INR / dzienniczek: Nie potrzebuję , Wersja drukowana (+ 1,00 zł)
Refundacja NFZ: Z.04.02.00 - dorośli 18+ , Z.04.02.01 - dzieci do 18 roku (- 36,00 zł), Z.04.02.00 - inwalidzi wojenni, inw. wojskowi, osoby represjonow , Bez refundacji (+ 324,00 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com