

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-d-dimery-zakrzepica-zyl-glebokich-zatorowosc-plucna-p-126.html>

Test d-dimery - zakrzepica żył głębokich - zatorowość płucna

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Numer katalogowy	05285
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Aby uzyskać ofertę, skontaktuj się z nami.

[Aktualna data ważności testów](#)

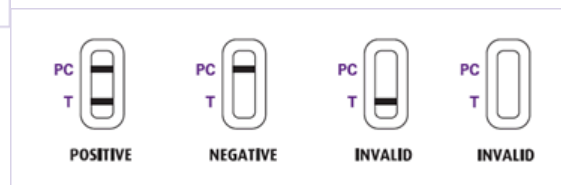
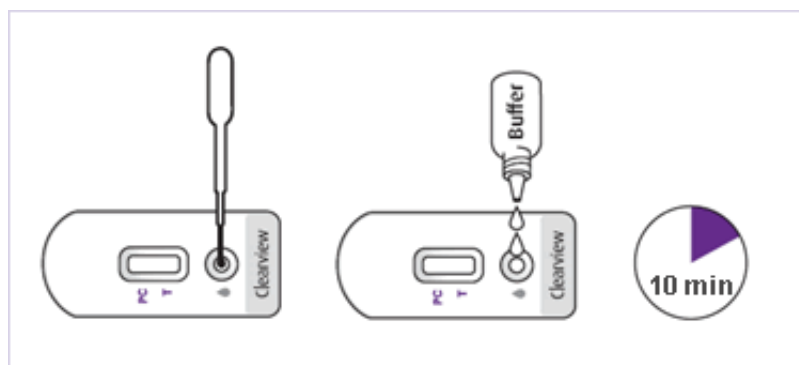
Nie w porę zdiagnozowana i nie leczona zakrzepica żył głębokich (ZŻG) może doprowadzić do najgroźniejszego z powikłań – do zatorowości płucnej (ZP). Skrzepliny mogą przemieszczać się do płuc, blokując tętnicę płucną lub jedno z jej odgałęzień.

Co najmniej u połowy pacjentów z ZŻG można rozpoznać zatorowość płucną mimo, iż u większości z nich nie występują typowe objawy. W 80% przypadków lekarze nie spodziewają się takiej diagnozy, a prawidłowe rozpoznanie stawiane jest dopiero po autopsji.

Symptomy, które powinny sugerować podejrzenie zatorowości płucnej:

- ból w klatce piersiowej
- tkliwość uciskowa klatki piersiowej
- ból pleców i/lub ramion
- ból w górnej części brzucha
- omdlenie
- bolesne oddychanie
- pierwsze pojawienie się świszczącego oddechu
- każda nowa arytmia serca
- każde niewyjaśnione symptomy związane z klatką piersiową
- szybkie oddychanie, często związane z dusznością
- lęk i niepokój

Testy Simplify D-Dimer, posiadające znakomitą negatywną wartość predykcyjną (NPV) $\geq 98\%$ do wykluczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W czasie zaledwie 10 minut można z wysokim prawdopodobieństwem zdiagnozować pacjenta.

**Zestaw zawiera:**

- 10 kaset testowych
- 10 pipet do poboru krwi kapilarnej
- 10 pipet do poboru krwi żyłnej
- 1 x 2.6 ml substancji buforowej
- Ulotkę

Opcje Dodatkowe

- Płyny kontrolne
 - negatywny,
 - pozytywny,

Specyfikacja:

- Czulość: 100%
- Swistość: 52,9%

Testy tylko do użytku profesjonalnego